



OPTOMETRY EXAMINING  
BOARD OF CANADA

BUREAU DES EXAMINATEURS  
EN OPTOMÉTRIE DU CANADA

# Instructions et guide de préparation à l'examen, ECOS d'équipement



## Table des matières

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. ECOS d'équipement..... | 2 |
| Annexe A : .....          | 2 |
| Annexe B : .....          | 3 |



## 1. ECOS d'équipement

Les stations évaluant les compétences techniques comportent un patient de même qu'un mannequin. Le candidat interagit avec un patient tout au long de la station et peut être appelé à démontrer certaines facettes de la maîtrise d'une compétence technique en interagissant le patient, alors que d'autres facettes de cette même maîtrise doivent être démontrées à l'aide d'un mannequin prévu à cet effet.

Les patients avec lesquels vous mettrez à exécution diverses techniques ont été sélectionnés pour reproduire une situation caractéristique. Cependant, les modèles oculaires disposent de lourdes paupières pour vous mettre au défi lors des manipulations. En effet, il se peut que les paupières de certains des patients que vous traiterez durant votre carrière vous posent problème.

### Annexe A :



(Visionnez aussi la vidéo portant sur le déroulement de l'examen clinique objectif structuré à l'adresse [www.oebc.ca](http://www.oebc.ca))

Chaque candidat utilise le même équipement à des fins de normalisation. L'équipement d'optométrie utilisé est énuméré dans le tableau ci-dessous.

| Équipement            | Modèle et fabricant   | Renseignements de référence                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tonomètre             | Perkins MK3           | Guide de référence rapide et instructions d'utilisation du TONOMÈTRE PERKINS (en anglais seulement)<br><br><a href="#">Perkins Mk3</a> (en anglais seulement) |
| Casque BIO            | Heine OMEGA 600       | <a href="https://www.heine.com/en/products/omega-600">https://www.heine.com/en/products/omega-600</a> (en anglais seulement)                                  |
| Lampe à fente         | Z800                  |                                                                                                                                                               |
| Base de lampe à fente |                       |                                                                                                                                                               |
| Jeu de lentilles      |                       |                                                                                                                                                               |
| Verre gonioscopique   | 3 mirror              |                                                                                                                                                               |
| Rétinoscope           | Heine Beta 200 NT3.5V |                                                                                                                                                               |
| Module Micro Rec      |                       | <a href="https://customsurgical.co/microrec/">https://customsurgical.co/microrec/</a>                                                                         |

Annexe B :

Photos d'équipement d'optométrie montrer à quoi s'attendre s'il y a un patient dans la station ou un modèle UNIQUEMENT

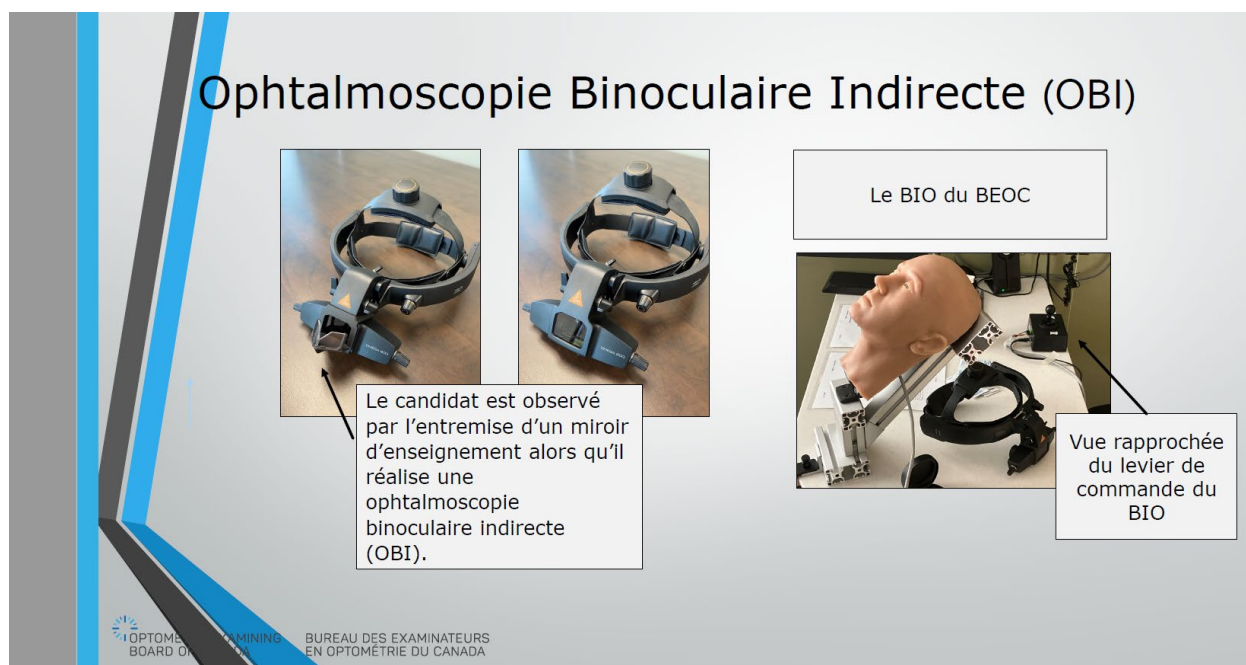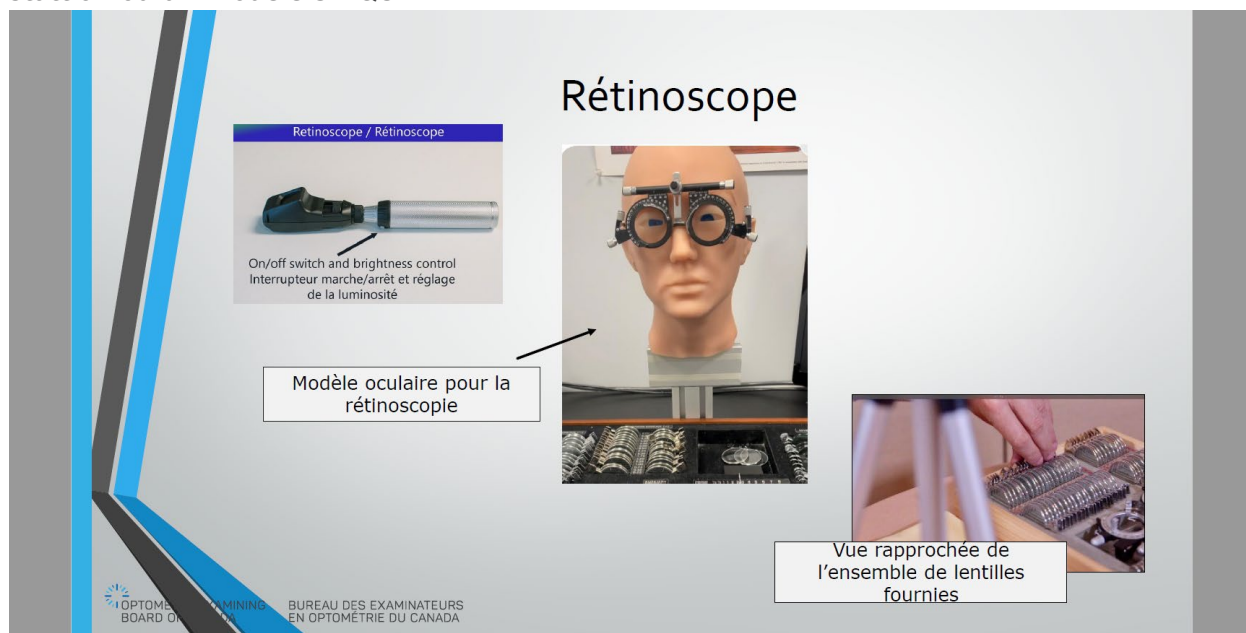


## Gonioscopie



Un téléphone cellulaire et une technologie de visionnement sont utilisés pour cette station.

Le candidat est observé alors qu'il réalise une gonioscopie sur le patient.



## Tonomètre


Perkins MKIII Tonometer



[https://www.haag-streit.com/fileadmin/Haag-Streit\\_UK/Downloads/CCO\\_downloads/Perkins\\_downloads/Perkins\\_quick\\_guide.pdf](https://www.haag-streit.com/fileadmin/Haag-Streit_UK/Downloads/CCO_downloads/Perkins_downloads/Perkins_quick_guide.pdf)



Tonomètre en action

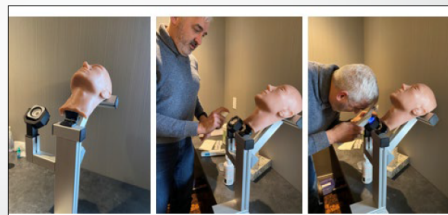

Les candidates et les candidats utilisent régulièrement l'examen visuel de Goldman durant leur formation. Or, il est parfois impossible d'y avoir recours pour diverses raisons (p. ex., le patient présente une scoliose, l'examen est réalisé à l'hôpital ou dans une résidence, etc.). C'est pour cette raison que vous devez réaliser l'examen de Perkins lors de l'examen clinique objectif structuré. Dans le cadre de cette station, vous devez expliquer pourquoi la mesure de la pression est importante et formuler des recommandations en fonction d'une lecture précise.